



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 54.337.541/0001-39
Razão Social: THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMA
Nome Fantasia: LIMA LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2026
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/09/2025
Receita Municipal	Validade:	13/09/2025



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMA**

CPF/CNPJ: **54.337.541/0001-39**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:30:32 do dia 25/03/2025 , com validade até o dia 24/04/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 1C7lGOqiersccV0nfDpn

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMA**

CPF/CNPJ: **355.544.628-20**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:30:57 do dia 25/03/2025 , com validade até o dia 24/04/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: sif1uFF18ICZ8mEQ6zwz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CNPJ: 54.337.541/0001-39

I.E.:135.611.559.114

INSC. MUN.: 1.276.142-7

PROPOSTA DE PREÇOS**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 325/2025 CÓD. VERIFICADOR: 9GZFAP6Q**

A 54.337.541 THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMA inscrita no CNPJ sob nº 54.337.541/0001-39, estabelecida na Rua Dilermando Dias dos Santos, nº 85, telefone/fax nº 11-97596-9810, e-mail limalicitacoes2024@gmail.com, propõe fornecer em face do resultado obtido no certame em epígrafe, com seus respectivos preços unitários nos seguintes termos:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTDE.	UNID	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM AÇO ATÉ 120KG - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em Aço de Alta Qualidade; Chassi tubular robusto e resistente; Dobrável em sistema Duplo X (cross-brace); Almofada com espuma de boa densidade com capa; Estofamentos em Nylon resistentes, duráveis e laváveis fixados com parafusos; Estofamento e Almofada: Preto; Apoio de braços rebatível com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável para apoio de panturrilha; Rodas dianteiras de no mínimo 7,5" maciças;	Cadeira de Rodas D100 Dellamed		10	R\$ 770,99	R\$ 7.709,90

Endereço: R. Dilermando Dias dos Santos 85, Vila Isolina Mazzei, São Paulo/SP, Cep 02079-004 **Contato:** (11) 97596-9810 | limalicitacoes2024@gmail.com



CNPJ: 54.337.541/0001-39

I.E.:135.611.559.114

INSC. MUN.: 1.276.142-7

	Rodas traseiras de 24" raíadas, de aço, com eixo fixo e com pneus maciços de borracha macia e antifuro; Aro de propulsão das rodas traseiras; Protetor lateral de roupas integrado; Alavanca de freio em aço ergonômica funcional; Tip-assist emborrachado - pedal de apoio para o condutor incorporado no chassi, para auxiliar na transposição de pequenos obstáculos; Material da Manopla em pvc e Pedaleira em Polipropileno; Largura de Assento (espaço interno) mínimo 44 cm; Capacidade de Peso: Até 120 kg; Incluso: Cadeira de Rodas, Almofada, Apoios, Acessórios e Manual;						
VALOR TOTAL:							R\$ 7.709,90

- **Validade da proposta:** 60 dias contados a partir da data da apresentação da proposta;
- **Prazo de entrega:** 20 dias úteis, após emissão e recebimento do empenho, em remessa única.

Declaramos, ainda, que estamos em condições de atender todas as exigências contidas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 325/2025 CÔD. VERIFICADOR: 9GZFAP6Q**

Endereço: R. Dilermando Dias dos Santos 85, Vila Isolina Mazzei, São Paulo/SP, Cep 02079-004 **Contato:** (11) 97596-9810 | limalicitacoes2024@gmail.com



CNPJ: 54.337.541/0001-39

I.E.:135.611.559.114

INSC. MUN.: 1.276.142-7

Dados da Empresa:

Razão Social: 54.337.541 THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMA – OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CNPJ: 54.337.541/0001-39 – I.E. 135.611.559.114
End: RUA DILERMANDO DIAS DOS SANTOS, 85, VILA ISOLINA MAZZEI, SÃO PAULO/SP, CEP 02079-004 Telefone: (11)-97596-9810

E-mail: limalicitacoes2024@gmail.com Banco: BB / Conta: 33216-X / Agência: 1874-0

SÃO PAULO, 26 de março de 2025

THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF 355.544.628-20
RG 43.797.851-5

54.337.541/0001-39

54.337.541 THIAGO VIANA
FERREIRA DE LIMA

Rua Dilermando Dias dos Santos
85, Vila Isolina Mazzei
São Paulo/SP 02079-004

Endereço: R. Dilermando Dias dos Santos 85, Vila Isolina Mazzei, São Paulo/SP,
Cep 02079-004 **Contato:** (11) 97596-9810 | limalicitacoes2024@gmail.com

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	DELLAMED S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11.666.105/0001-09
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.07.959-5
Nome do Dispositivo Médico	Cadeira de Rodas Manual Dellamed
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Cadeira de Rodas
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80795950050
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351432184202319
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: GUANGDONG VHEALTH MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C007506 - Endereço: NO. 1-2, TONGXINGANG, SHANGYUANFANG, LIANGDENG VILLAGE, DANZAO TOWN, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	31/07/2023
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Cadeira de Rodas D100 Digital - V01.pdf	0013961250 - 06/01/2025 16:46:25

Modelo Produto Médico
D100

Cadeira de rodas D100

Código: 05588

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS



Suporta até 120 Kg



Possui registro na Anvisa e é certificada pelo Inmetro



Largura do assento de 46 cm



Fácil de transportar, cabe em qualquer porta-malas


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de estrutura	Dobrável com fechamento em duplo X
Material da estrutura	Aço carbono
Tipo de pintura	Eletrostática epóxi
Tipo do encosto	Removível
Estofamento de encosto/assento	Acolchoado em nylon de alta resistência
Almofada	Não possui
Apoio de braço	Fixo
Apoio de pés	Rebatível e com ajuste de altura
Apoio de pernas/pedal	Removível
Tip Assist	Sim
Protetor de roupa	Sim
Freios	Dos dois lados com acionamento para frente
Faixa de panturrilha	Sim
Rodas dianteiras	8" maciça, com rolamentos blindados
Garfo da roda dianteira	Aço carbono
Eixo dianteiro	Sem sistema quick-release
Roda traseira	24" em aço carbono e rolamentos blindados
Pneu da roda traseira	Anti Furo 24"
Aro de propulsão	Aço Carbono
Eixo traseiro	Sem sistema quick-release
Manopla	Emborrachada
Peso líquido	16,3 Kg
Número do registro ANVISA	80795950050 - V / 80795950061 - C / 80795950063 - I
Medidas do assento (L x P)	46 X 40 cm
Garantia	Estrutura: 12 meses Demais componentes: 6 meses
GTIN	7898952570435


Compre com:
• Almofada Air Cell
• Almofada Air Basic




VISTA SUPERIOR

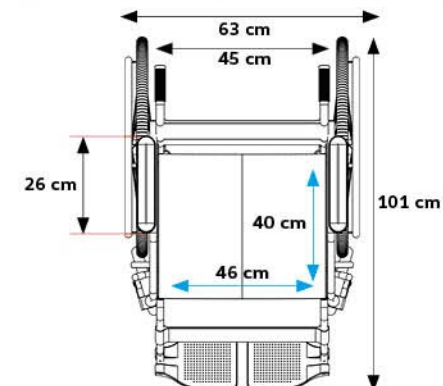

VISTA FRONTAL

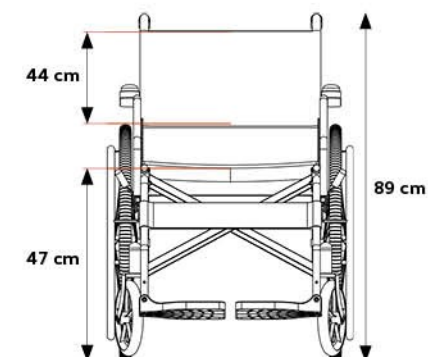

DOBRADA

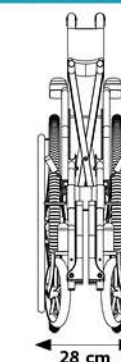

Medidas da cadeira dobrada: 79 x 28 x 73 cm



Medidas - Caixa Unitária C x L x A: 81 x 27,5 x 76 cm

Cadeira de Rodas

206

MODELO D100

Português / espanhol



dellamed
Home

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir sua Cadeira de Rodas Manual Modelo D100.

Este Manual de Instruções contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro da sua cadeira de rodas.

CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

Detentor do registro: **DELLAMED S.A.**

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço:

Rua Henrique Rech, 312 - Bairro Sanvitto II, Cinquentenário

CEP 95012-613 - Caxias do Sul/RS - Brasil

Fabricante: Guangdong Vhealth Medical Technology Company Limited.

Endereço: N.º. 1-2, Tongxingang, Shangyuanfang, Liangdeng Village, Danzao Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China.

Registro da Anvisa: 80795950050



QUEREMOS OUVIR VOCÊ!

Atendimento ao Consumidor Brasileiro:

0800.604.8008

assistenciatecnica@dellamed.com.br



A imagem abaixo apresenta a sua Cadeira de Rodas D100 e seus principais componentes com suas respectivas terminologias:



Componentes	Descrição
1. Manoplas	As manoplas são projetadas para que o acompanhante possa impulsionar a cadeira de rodas. No entanto, elas não devem ser usadas sozinhas para levantar a cadeira ao transportar obstáculos ou meios-fios. Para essa manobra, o acompanhante deve utilizar o tip assist com o pé para levantar a parte frontal da cadeira de rodas.
2. Encosto	O encosto e o estofado foram projetados para proporcionar o máximo conforto ao usuário.
3. Apoio de Braços	As almofadas de PVC são fixadas nos apoios de braços para maior conforto e podem ser substituídas, quando necessário, por peças de reposição.
4. Assento	O assento é feito de material impermeável e estofado para proporcionar máximo conforto ao usuário. Revise periodicamente em busca de sinais de rasgos, flacidez ou afrouxamento, substituindo se estiver danificado. Lembre-se: o estofamento do assento é o principal suporte de peso.
5. Rodas e Pneus Traseiros	Sua cadeira de rodas está equipada com rodas de longa durabilidade. Caso observe um pneu danificado ou desgastado, substitua toda a roda.
6. Aro de impulsão	O aro de impulsão possui diâmetro menor que a roda e é usado pelo usuário para deslocar a cadeira de rodas.
7. Freios	Os freios são utilizados para manter a cadeira de rodas em posição estacionária e encontram-se em ambos os lados da cadeira.
8. Apoio para Pés	Esses suportes destinam-se apenas para o apoio dos pés enquanto estiver sentado na cadeira de rodas. Não fique de pé sobre o apoio para os pés.
9. Barras em Duplo X	A barra transversal em cruz (Duplo X) permite que a cadeira de rodas seja aberta e fechada facilmente. Inspeção-a regularmente quanto a sinais de desgaste e empenamento.

10. Rodas Dianteiras

As rodas dianteiras têm pneus sólidos à prova de furos. Verifique-os regularmente para monitorar o desgaste. Recomenda-se substituir ambos os pneus dianteiros ao mesmo tempo para garantir nivelamento adequado da cadeira de rodas. Periodicamente, verifique e aperte o parafuso e a porca do garfo do rodízio para garantir um ajuste seguro, mas com rotação livre. O garfo do rodízio permite que a cadeira de rodas seja dirigida. A contra porca de ajuste, localizada sob a tampa do rodízio, não deve estar muito apertada, pois pode dificultar a direção.

209

3. MONTAGEM

PASSO 1: Empurre os tubos laterais do assento para os lados até que a cadeira esteja completamente aberta. Nesta etapa, certifique-se de manter os dedos longe das partes móveis para evitar acidentes.



Nota: Os tubos do assento devem estar totalmente engatados no suporte da estrutura do assento antes de se sentar, como indicado no quadro 2.

PASSO 2: Realize o encaixe do encosto na estrutura principal. Com o parafuso em mãos, transpasse-o entre o furo do tecido do encosto até a estrutura. Por fim, encaixe a bucha plástica na extremidade do parafuso e realize o aperto com o manipulador para encerrar a fixação das partes.



PASSO 3: Encaixe os apoios para pés na estrutura principal, pressionando o pino click. Certifique-se de ouvir um som de clique, confirmando que os apoios foram encaixados corretamente.



PASSO 4: Por fim, finalize a montagem instalando a faixa de panturrilhas, envolvendo-a nos apoios para pés. Observe que o lado onde há o velcro deve ficar virado para trás.

210



4. RECOMENDAÇÕES GERAIS E DICAS DE USO

4.1 Diretrizes gerais:

É essencial ler e entender completamente este manual antes de montar ou usar esta cadeira de rodas. Ressaltamos que as cadeiras de rodas são destinadas exclusivamente ao uso pessoal de indivíduos com mobilidade reduzida. Não exceda o peso máximo suportado por este produto, pois o excesso de peso acelerará o desgaste, aumentando o risco de quedas, tombos ou perda de controle, podendo causar danos graves ao usuário ou a outras pessoas.

Recomendamos a escolha de uma cadeira de rodas que atenda às necessidades do usuário e que seja aprovada por um profissional habilitado. A decisão adequada depende de fatores como aptidão, força, equilíbrio, coordenação e as diversas situações diárias que o usuário enfrentará (como locais de residência, trabalho e outros lugares onde a cadeira será utilizada). Considere também a inclusão de opcionais para segurança e conforto, como rodas antitombo, apoio de panturrilha, cintos ou sistemas de assento especiais.

Antes de utilizar o produto, verifique se todas as partes e acessórios estão montados corretamente, as rodas estão em boas condições de funcionamento, a cadeira está nivelada e todas as rodas estão em contato com o chão durante o uso.

Para uso seguro, lembre-se:

- Respeite os limites de alcance para objetos, inclinação para trás, ângulos máximos de inclinação, uso dos freios manuais, tipo de pneus e limite de peso.
- Os suportes de apoio dos pés são projetados apenas para sustentar os pés enquanto estiver sentado. Não fique em pé sobre eles. Tome cuidado próximo a chamas abertas ou cigarros acesos.

ATENÇÃO: Qualquer modificação no produto sem a permissão expressa da Dellamed invalidará a garantia.

4.2 Utilização em terrenos diversos:

Terreno: Evite utilizar a cadeira em terrenos perigosos, como ladeiras muito íngremes, pisos escorregadios, cascalho solto ou grama molhada.

Escadas Rolantes: Não utilize a cadeira de rodas em escadas rolantes.

Uso em trânsito: Lembre-se de que, ao usar a cadeira de rodas na rua, você está sujeito às regras de trânsito. Em ambientes com pouca visibilidade, vista roupas claras ou com adesivos refletivos para ser facilmente visto por terceiros.

Usuário: Certifique-se de que qualquer pessoa que o auxilie leu e segue todas as advertências e instruções deste manual.

Siga sempre as orientações do seu médico, enfermeira ou terapeuta, e aprenda métodos seguros de uso de acordo com suas habilidades.

4.3 Aspectos de segurança:

Centro de equilíbrio: O centro de equilíbrio da cadeira de rodas é influenciado por fatores como a altura da cadeira, a distância entre as rodas traseiras, a altura e o ângulo do assento, bem como a postura e a distribuição

de peso do usuário. Ao subir rampas ou aclives e transportar objetos na parte de trás da cadeira, o centro de equilíbrio pode ser afetado. É essencial consultar um médico ou fisioterapeuta para determinar o **211** centro de equilíbrio para você. Antes de fazer qualquer modificação ou ajuste na cadeira, consulte seu revendedor autorizado, pois podem ser necessárias outras mudanças para corrigir o centro de equilíbrio. Tenha cuidado e sempre solicite ajuda até que você conheça o centro de equilíbrio ideal da sua cadeira para evitar possíveis acidentes.

Obstáculos: Buracos, elevações e pavimentos quebrados podem danificar a cadeira de rodas e causar quedas ou perda de controle. Ao encontrar obstáculos, mantenha as mãos no aro de impulsão e avalie a situação antes de prosseguir. Nunca empurre ou puxe objetos, pois isso pode impulsionar a cadeira de rodas de forma inesperada.

4.3.1 Ajudando o usuário a subir um meio-fio:

- Fique atrás da cadeira de rodas.
- Incline a cadeira de rodas para cima nas rodas dianteiras, fazendo-as subir o meio-fio.
- Avance até que as rodas dianteiras estejam no nível superior do meio-fio.
- Avance, encostando as rodas dianteiras no nível superior.
- Continue avançando até que as rodas traseiras encostem à face do meio-fio.
- Erga e role as rodas traseiras até o nível superior.

4.3.2 Ajudando um usuário de cadeira de rodas a descer um meio-fio:

- Fique atrás da cadeira de rodas.
- Vire a cadeira de rodas antes de se aproximar da extremidade do meio-fio e puxe para trás.
- Desça cuidadosamente até estar fora do meio-fio ou degrau.
- Puxe a cadeira de rodas até que as rodas traseiras alcancem a extremidade do meio-fio e permita que rolem lentamente para o nível abaixo.
- Incline a cadeira de rodas para trás, levantando as rodas dianteiras do meio-fio quando as rodas traseiras estiverem seguras no nível abaixo.
- Mantenha a cadeira de rodas equilibrada e dê passos pequenos para trás.
- Vire a cadeira de rodas e abaixe suavemente as rodas dianteiras até o chão.

Lembre-se de sempre subir e descer declives e aclives em linha reta para evitar o risco de capotamento da cadeira de rodas. Evite declives acentuados, pois podem causar instabilidade.

4.4 Utilização da cadeira de rodas:

Inclinando-se para a frente: Posicione a cadeira de rodas o mais próximo possível do objeto que deseja alcançar. Estenda os rodízios dianteiros para a frente e trave as rodas traseiras. Estenda apenas o braço para pegar objetos ao alcance do comprimento do braço, permanecendo sentado na posição normal.

Inclinando-se para trás: Posicione a cadeira de rodas próxima ao objeto desejado. Estenda o braço apenas até onde alcançar sem alterar a posição. Evite se inclinar sobre a parte superior do estofamento traseiro para não mudar o centro de gravidade e evitar tombos.

Inclinando-se para os lados: Mova a cadeira de rodas próxima ao objeto desejado e alinhe os rodízios frontais na direção desejada. Trave as rodas traseiras completamente. Não mude a posição sentada ou o centro de gravidade em direção ao objeto que está alcançando, para evitar tombos.

Transferência: Antes de sentar ou sair da cadeira de rodas, assegure-se de que o espaço entre os dois assentos seja mínimo. Certifique-se de travar as rodas para evitar o movimento da cadeira. Gire os rodízios na direção do assento para o qual deseja mover-se. Levante os pés e dobre os suportes dos pés para o lado, mas nunca fique de pé sobre eles. É essencial que as transferências sejam supervisionadas por um profissional de saúde capacitado até que o usuário da cadeira de rodas esteja familiarizado com o procedimento.

4.5 Ajustando a altura das peseiras do apoio para pés:

Primeiramente, solte o parafuso que fixa todas as partes. Após ajustar a altura adequada da peseira, encaixe-a na estrutura da cadeira de rodas utilizando as buchas plásticas curvas ao redor do tubo, posicionando-as entre o pedal e a estrutura. Certifique-se de alinhar os furos dos componentes com a furação escolhida e, por fim, aperte o pedal com o parafuso, colocando a porca na outra extremidade da peça para garantir um aperto correto.



5. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Sua cadeira de rodas foi projetada para garantir durabilidade e segurança, proporcionando uma experiência confiável de mobilidade. Para assegurar o melhor desempenho e prolongar a vida útil da cadeira, é importante realizar uma manutenção preventiva regularmente.

Medidas preventivas semanais:

- Verifique o estado geral da cadeira de rodas, incluindo a integridade das estruturas, partes metálicas e componentes.
- Verifique se há folgas, desgaste excessivo ou sinais de danos nas rodas e pneus.
- Limpe os estofados do encosto e assento com uma solução de sabão neutro e água para mantê-los em boas condições.
- Certifique-se de que os freios estão funcionando corretamente, e não apresentam desgaste ou folga.

Medidas Preventivas Mensais:

- Lubrifique o parafuso central da barra transversal (duplo X) com óleo de máquina multiuso para garantir seu bom funcionamento.
- Verifique a integridade dos pneus para garantir a estabilidade e melhor desempenho nas rodas.
- Verifique a fixação das rodas nos rodízios e aperte o parafuso e porca, conforme necessário, para permitir giro livre.
- Verifique se os freios das rodas traseiras estão em bom estado e funcionando adequadamente.
- Verifique a integridade dos elementos de fixação das rodas traseiras.

Medidas Preventivas Trimestrais:

- Realize uma inspeção detalhada da cadeira de rodas, incluindo todas as partes e componentes para detectar sinais de desgaste ou possíveis danos.
- Certifique-se de que todas as partes metálicas estejam limpas, livres de corrosão e mantenham o acabamento adequado.
- Verifique a estabilidade e alinhamento das rodas, corrigindo eventuais desalinhamentos.
- Certifique-se de que o centro de equilíbrio da cadeira de rodas está ajustado corretamente.

Medidas Preventivas Semestrais:

- Realize uma verificação completa da cadeira de rodas, incluindo sistema de fechamento e abertura, garantindo que todas as partes estejam funcionando sem problemas.
- Verifique se todas as peças e componentes estão devidamente fixados e aperte os parafusos conforme necessário.
- Inspeção os suportes de apoio dos pés e certifique-se de que estão em boas condições.

Medidas Preventivas Anuais:

- Realize uma manutenção abrangente com um profissional especializado para verificar todos os sistemas e componentes da cadeira de rodas.
- Realize a troca dos pneus e rodas, caso necessário, para garantir a segurança e desempenho adequados.
- Essas medidas preventivas são essenciais para garantir o melhor desempenho e a durabilidade de sua cadeira de rodas manual. Lembre-se de que a manutenção regular é fundamental para assegurar sua segurança e conforto durante o uso. Em caso de dúvidas ou necessidade de assistência técnica, entre em contato com a Dellamed ou um posto autorizado.

A tabela abaixo lista as causas de problemas mais comuns e suas respectivas soluções. Caso o problema persista ou não esteja listado nesta tabela, entre em contato com nossa assistência técnica ou procure um posto autorizado.

Causa	Possível solução
A cadeira de rodas move-se irregularmente (guinadas para um dos lados).	• Verifique a integridade dos pneus traseiros e, se necessário, troque-os. • Verifique se alguma das rodas está travada e destrave-a. • Certifique-se de que ambas as rodas dianteiras estejam em contato com o solo e verifique se há avarias.
• A cadeira de rodas vibra e apresenta ruídos.	• Reaperte os parafusos se necessário, aplique óleo lubrificante nas áreas com peças móveis. • verifique se ambas as rodas dianteiras estão em contato com o solo e substitua os pneus traseiros, caso necessário.
• O freio não está mais travando adequadamente.	• Verifique a banda de rodagem dos pneus e troque-os caso estejam desgastados. • Verifique a integridade dos pneus traseiros e faça a regulagem correta dos dispositivos de freio.
• A barra transversal (Duplo X) está apresentando rigidez ao abrir e fechar a cadeira de rodas.	• Lubrifique o parafuso central da barra com óleo de máquina multuso.
• As rodas dianteiras não estão funcionando corretamente.	• Verifique regularmente se o parafuso e a porca que prendem a roda ao garfo do rodízio estão apertados adequadamente, permitindo giro livre.
• A cadeira de rodas apresenta instabilidade.	• Verifique o desgaste dos pneus. Caso seja necessário realizar a troca, troque ambos os pneus ao mesmo tempo para não comprometer a estabilidade da cadeira de rodas. • Verifique se as rodas giram livremente.

7. ESPECIFICAÇÕES

Modelo	D100
Peso máximo suportado	120 kg
Medidas aproximadas da cadeira aberta (CxLxA)	C100 x L62 x A89 cm
Medidas aproximadas da cadeira dobrada, com encosto rebatido e com os apoios de pés removidos (CxLxA)	C78 x L28 x A73 cm
Peso líquido do produto	13,9 kg
Largura do Assento	46 cm
Profundidade do Assento	40 cm
Altura do assento ao piso	58 cm
Altura do encosto das costas	39 cm
Altura entre o apoio para os braços e o assento	22 cm
Distância entre os braços	45 cm
Diâmetro externo da roda traseira	59 cm
Diâmetro externo do aro de propulsão	58 cm
Diâmetro externo da roda dianteira	20 cm

1 – CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

a) O produto acima identificado possui garantia legal de 90 (noventa) dias para todos os seus componentes, sendo estes: tecido do encosto, tecido do assento, manoplas, rodas, pedais, rolamentos, garfo dianteiro, apoio de braço, freios e peças plásticas. Findando este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual de:

- 9 (nove) meses para a estrutura - totalizando 1 (um) ano de garantia;

- 3 (três) meses para demais componentes;

b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.

c) Está garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.

d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.

e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

2 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade apresentada pela Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela fabricante.

b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada dentro do mesmo perímetro urbano do consumidor, são de responsabilidade do usuário.

c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas à Dellamed se encontra disponível no website oficial da fabricante: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>.

3 – EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada à Dellamed;

b) Alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;

c) O desgaste natural do produto;

d) Danos decorrentes de falhas ou sobrecargas no fornecimento de energia elétrica;

e) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;

f) Ligação do produto em rede elétrica/tensão inadequada, ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;

g) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;

h) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;

i) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;

j) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;

k) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inadequado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;

l) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;

m) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;

n) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inadequado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;

o) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;

p) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;

q) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.

MODELO D100

1. INTRODUCCIÓN

Apreciado Cliente,

Gracias por adquirir su Silla de Ruedas Manual Modelo D100.

Este Manual de Instrucciones contiene las recomendaciones necesarias para el uso adecuado y seguro de su silla de ruedas.

CONOZCA DELLAMED

Creada en 2010, en la ciudad de Caxias do Sul - RS, Dellamed es sinónimo de calidad e innovación. Buscando siempre el buen servicio, Dellamed tiene como lema principal la salud de los clientes en 1º lugar, buscando así ofrecer los mejores productos del mercado para poder atender eficientemente a todos los consumidores finales.

DELLAMED S.A.

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsable Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Dirección:

Rua Henrique Rech, 312 - Bairro Sanvitto II, Barrio Cinquentenário CEP 95012-613 - Caxias do Sul/RS – Brasil

Fabricante: Guangdong Vhealth Medical Technology Company Limited.

Dirección: N°. 1-2, Tongxingang, Shangyuanfang, Liangdeng Village, Danzao Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China.

Registro de Anvisa: 80795950050

2. CONOCIENDO EL PRODUCTO

La imagen de abajo presenta su Silla de Ruedas D100 y sus principales componentes con las respectivas terminologías:



Componentes	Descripción	216
1. Manoplas	Los mangos están diseñados para que el ayudante empuje la silla de ruedas. No deben usarse solos para levantar la silla de ruedas al cruzar obstáculos o bordillos.	
2. Respaldo	El respaldo está fabricado en material impermeable y tapizado para proporcionar el máximo confort al usuario.	
3. Apoyabrazos	Las almohadillas de PVC están unidas al apoyabrazos para mayor comodidad y puede ser reemplazada, cuando sea necesario, con repuestos.	
4. Asiento	El asiento está fabricado en material impermeable y tapizado para proporcionar el máximo confort al usuario. Verifique periódicamente si hay signos de quiebres, flacidez o aflojamiento, y reemplácelos si están dañados. Recuerde: El tapizado de los asientos es el principal material de soporte/peso.	
5. Ruedas y Llantas traseras	Tu silla de ruedas está equipada con ruedas de larga durabilidad. Si notas un neumático dañado o desgastado, reemplaza toda la rueda.	
6. Aro de Propulsión	El aro de propulsión tiene un diámetro menor que la rueda, siendo el componente que el usuario debe utilizar para mover la silla de ruedas.	
7. Frenos	Los frenos se utilizan para mantener la silla de ruedas en posición estacionaria y se encuentran en ambos lados de la silla.	
8. Ruedas delanteras	Las ruedas delanteras tienen neumáticos sólidos a prueba de pinchazos. Estos deben revisarse constantemente para monitorear cualquier desgaste. Las sillas de ruedas se vuelven difíciles de manejar y propulsar cuando las superficies de los neumáticos/ruedas están desgastadas. Se recomienda reemplazar ambos neumáticos delanteros al mismo tiempo para evitar que un lado de la silla de ruedas quede más alto que el otro. La rueda está unida al tenedor de la rueda por el eje del perno y asegurada por la tuerca. Periódicamente, este perno y tuerca deben revisarse y apretarse, si es necesario, para tener un ajuste perfecto de una rotación libre. Apretar el tenedor de la rueda permite manejar la silla de ruedas. Una contratuerca se encuentra debajo de la tapa de la rueda. Si la contratuerca está demasiado apretada, se vuelve difícil de manejar.	
9. reposapiés	Estos soportes solo están destinados a apoyar los pies cuando está sentado en la silla de ruedas. Bajo ninguna circunstancia debe pararse en el reposapiés.	
10. Barra Transversal	El funcionamiento de la barra transversal permite que la silla de ruedas se abra y cierre fácilmente. Debe inspeccionarse regularmente en búsqueda de signos de desgaste y deformación.	

3. MONTAJE

PASO 1: Empuje los tubos laterales del asiento hacia los lados hasta que la silla esté completamente abierta. En este paso, asegúrese de mantener los dedos alejados de las piezas móviles para evitar accidentes.



217

Nota: Los tubos del asiento deben estar completamente enganchados en el soporte del armazón del asiento antes de sentarse, como se muestra en la Tabla 2.

PASO 2: Realiza el ensamblaje del respaldo en la estructura principal. Con el tornillo en mano, colóquelo en el marco de la silla de ruedas usando los encajes de plástico curvos alrededor del tubo. Asegúrese de alinear los orificios del componente con el orificio elegido y, finalmente, apriete el pedal con el tornillo, colocando la tuerca en el otro extremo de la pieza para asegurar un correcto ajuste.



PASO 3: Encaja los apoyos para pies en la estructura principal, presionando el botón de clic. Asegúrese de escuchar un clic, lo que confirma que los apoyos han sido colocados correctamente.



PASO 4: Finalmente, complete el montaje instalando la banda de la pantorrilla, envolviéndola alrededor de los reposapiés. Tenga en cuenta que el lado donde se encuentra el velcro debe mirar hacia atrás.



4.1 Directrices generales:

Es esencial leer y comprender completamente este manual antes de ensamblar o usar esta silla de ruedas. Destacamos que las sillas de ruedas están destinadas exclusivamente al uso personal de personas con movilidad reducida. No exceda el peso máximo soportado por este producto, ya que el exceso de peso acelerará el desgaste y aumentará el riesgo de caídas, vuelcos o pérdida de control, lo que podría causar lesiones graves al usuario o a otras personas.

Recomendamos elegir una silla de ruedas que se ajuste a las necesidades del usuario y que esté homologada por un profesional calificado. La decisión adecuada depende de factores como la aptitud, la fuerza, el equilibrio, la coordinación y las diversas situaciones diarias a las que se enfrentará el usuario (como lugares de residencia, trabajo y otros lugares donde se utilizará la silla). Considere también agregar opciones de seguridad y comodidad, como ruedas antivuelco, soporte para pantorrillas, cinturones o sistemas de asientos especiales.

Antes de utilizar el producto, compruebe que todas las piezas y accesorios estén correctamente montados, que las ruedas funcionen correctamente, que la silla esté nivelada y que todas las ruedas estén en contacto con el suelo durante su uso.

Para un uso seguro, recuerde:

- Respetar los límites de alcance de objetos, inclinación hacia atrás, ángulos máximos de inclinación, uso de frenos de mano, tipo de llantas y límite de peso.
- Los reposapiés están diseñados únicamente para apoyar los pies mientras está sentado. No se pare sobre ellos. Tenga cuidado con las llamas abiertas o los cigarrillos encendidos.

ATENCIÓN: Cualquier modificación al producto sin el permiso expreso de Dellamed invalidará la garantía.

4.2 Uso en diferentes terrenos:

Terreno: Evite utilizar la silla de ruedas en terrenos peligrosos, como pendientes muy empinadas, suelos resbaladizos, gravilla suelta o hierba mojada.

Escaleras eléctricas: No utilice la silla de ruedas en las escaleras eléctricas.

Uso en carretera: Recuerda que, al utilizar la silla de ruedas en la calle, estás sujeto a las normas de tránsito. En entornos con poca visibilidad, use ropa o calcomanías reflectivas para que los demás lo vean fácilmente.

Usuario: Asegúrese de que cualquier persona que lo ayude haya leído y seguido todas las advertencias e instrucciones de este manual.

Siga siempre los consejos de su médico, enfermera o terapeuta y aprenda métodos de uso seguros según sus capacidades.

4.3 Aspectos de seguridad:

Centro de equilibrio: el centro de equilibrio de la silla de ruedas está influenciado por factores como la altura de la silla, la distancia entre las ruedas traseras, la altura y el ángulo del asiento, así como la postura y la distribución del peso del usuario. Al subir rampas o pendientes y llevar objetos en el respaldo de la silla, el centro de equilibrio puede verse afectado. Es fundamental consultar a un médico o fisioterapeuta para determinar el mejor centro de equilibrio para usted. Antes de realizar modificaciones o ajustes en la silla, consulte a su distribuidor autorizado, ya que pueden ser necesarios cambios adicionales para corregir el centro de equilibrio. Tenga cuidado y siempre pida ayuda hasta conocer el centro de equilibrio ideal de su silla para evitar posibles accidentes.

Obstáculos: Los baches y el pavimento roto pueden dañar la silla de ruedas y hacer que se caiga o pierda el control. Cuando encuentre obstáculos, mantenga sus manos en el borde de empuje y evalúe la situación antes de continuar. Nunca empuje ni tire de objetos, ya que esto podría impulsar inesperadamente la silla de ruedas.

4.3.1 Ayudar al usuario a subir una plataforma o andén:

- Párese detrás de la silla de ruedas.
- Incline la silla de ruedas hacia arriba sobre las ruedas delanteras, conduciéndolas sobre el andén.
- Avance hasta que las ruedas delanteras estén en el nivel superior del andén.
- Avance, tocando las ruedas delanteras al nivel superior.
- Siga avanzando hasta que las ruedas traseras toquen la cara del andén.
- Levante y haga rodar las ruedas traseras hasta el nivel superior.

4.3.2 Ayudar a un usuario de silla de ruedas a bajar un andén:

- Párese detrás de la silla de ruedas.
- Gire la silla de ruedas antes de acercarse al borde del andén y tire hacia atrás.
- Descienda con cuidado hasta que esté libre del andén o escalón.
- Tire de la silla de ruedas hasta que las ruedas traseras lleguen al borde del andén y déjelas rodar lentamente.

hasta el nivel inferior.

- Inclíne la silla de ruedas hacia atrás, levantando las ruedas delanteras del andén cuando las ruedas traseras estén aseguradas en el nivel inferior.
 - Mantenga la silla de ruedas equilibrada y dé pequeños pasos hacia atrás.
 - Dé la vuelta a la silla de ruedas y baje suavemente las ruedas delanteras hasta el suelo.
- Recuerda subir y bajar pendientes siempre en línea recta para evitar el riesgo de vuelco de la silla de ruedas. Evite las pendientes pronunciadas ya que pueden causar inestabilidad.

4.4 Uso de la silla de ruedas:

Inclinarse hacia adelante: coloque la silla de ruedas lo más cerca posible del objeto que desea alcanzar. Extienda las ruedas delanteras hacia adelante y bloquee las ruedas traseras. Solo extienda su brazo para recoger objetos dentro del alcance de su brazo mientras permanece sentado en la posición normal.


Inclinarse hacia atrás: coloque la silla de ruedas cerca del objeto deseado. Extiende tu brazo solo hasta donde puedas alcanzar sin cambiar de posición. Evite inclinarse sobre la parte superior de la tapicería del respaldo, ya que esto cambiará el centro de gravedad y evitará que se vuelque.

Inclinación lateral: Mueva la silla de ruedas cerca del objeto deseado y alinee las ruedas delanteras en la dirección deseada. Bloquee completamente las ruedas traseras. No cambie su posición de sentado o el centro de gravedad hacia el objeto que está alcanzando para evitar volcarse.

Transferencia: Antes de subir o bajar de la silla de ruedas, asegúrese de que el espacio entre los dos asientos sea mínimo. Asegúrese de bloquear las ruedas para evitar que la silla se mueva. Gire las ruedas en la dirección del asiento al que desea moverse. Levante los pies y doble los soportes para los pies hacia un lado, pero nunca se pare sobre ellos. Es esencial que las transferencias sean supervisadas por un profesional de la salud capacitado hasta que el usuario de silla de ruedas esté familiarizado con el procedimiento.

4.5 Ajustando la altura de los reposapiés:

En primer lugar, afloja el tornillo que sujeta todas las partes. Después de ajustar la altura adecuada del reposapiés, encajalo en la estructura de la silla de ruedas usando los encajes de plástico curvos alrededor del tubo, colocándolos entre el pedal y el marco. Asegúrese de alinear los orificios del componente con el orificio elegido y, finalmente, apriete el pedal con el tornillo, colocando la tuerca en el otro extremo de la pieza para asegurar un correcto ajuste.

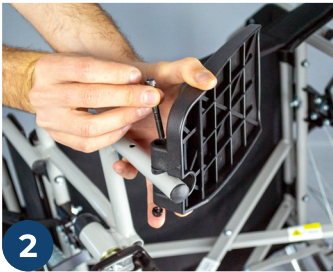

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Su silla de ruedas está diseñada para brindar durabilidad y seguridad, otorgando una experiencia de movilidad confiable. Para garantizar el mejor rendimiento y prolongar la vida útil de su silla, es importante realizar un mantenimiento preventivo con regularidad.

Medidas Preventivas Semanales:
• Verificar el estado general de la silla de ruedas, incluyendo la integridad de estructuras, partes metálicas y componentes. • Revise las ruedas y los neumáticos en busca de flojedad, desgaste excesivo o signos de daño. • Limpiar el tapizado del respaldo y del asiento con una solución de agua y jabón suave para mantenerlos en buen estado. • Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente y no tengan desgaste ni juego.

Medidas Preventivas Mensuales:

220

- Lubrique el tornillo central del travesaño (doble X) con aceite de máquina multiusos para garantizar su correcto funcionamiento.
- Verifique la integridad de los neumáticos para garantizar la estabilidad y un mejor rendimiento de las ruedas.
- Verifique la fijación de las ruedas en las ruedecillas y apriete el perno y la tuerca, según sea necesario, para permitir la rotación libre.
- Compruebe que los frenos de las ruedas traseras estén en buen estado y funcionando correctamente.
- Comprobar la integridad de las fijaciones de las ruedas traseras.

Medidas Preventivas Trimestrales:

- Realice una inspección detallada de la silla de ruedas, incluidas todas las piezas y componentes, en busca de signos de desgaste o posibles daños.
 - Asegúrese de que todas las piezas metálicas estén limpias, libres de corrosión y mantengan un acabado adecuado.
 - Verificar la estabilidad y alineación de las ruedas, corrigiendo las desalineaciones.
- Asegúrese de que el centro de equilibrio de la silla de ruedas esté ajustado correctamente.

Medidas Preventivas Semestrales:

- Efectuar una revisión completa de la silla de ruedas, incluido el sistema de cierre y apertura, asegurándose de que todas las piezas funcionen correctamente.
- Verifique que todas las piezas y componentes estén correctamente asegurados y apriete los tornillos según sea necesario.
- Inspeccione los reposapiés y asegúrese de que estén en buenas condiciones.

Medidas Preventivas Anuales:

- Realizar un mantenimiento integral con un especialista para revisar todos los sistemas y componentes de la silla de ruedas.
- Reemplace los neumáticos y las ruedas, si es necesario, para garantizar la seguridad y el rendimiento adecuados.
- Estas medidas preventivas son fundamentales para garantizar el mejor rendimiento y durabilidad de su silla de ruedas manual. Recuerde que el mantenimiento regular es esencial para garantizar su seguridad y comodidad durante el uso. En caso de dudas o necesidad de asistencia técnica, póngase en contacto con Dellamed o con un punto de servicio autorizado.

6. ESPECIFICACIONES

Modelo	D100
Peso máximo soportado	120 kg
Medidas aproximadas de la silla abierta (CxLxA)	C100 x L62 x A89 cm
Medidas aproximadas de la silla doblada, con el respaldo abatido y los reposapiés desmontados (CxLxA)	C78 x L28 x A73 cm
Peso neto del producto	13,9 kg
Ancho del asiento	46 cm
profundidad del asiento	40 cm
Altura del asiento al piso	58 cm
Altura del respaldo	39 cm
Altura entre reposabrazos y asiento	22 cm
Distancia entre los brazos	45 cm
Diámetro exterior de la rueda trasera	59 cm
Diámetro exterior del borde impulsor	58 cm
Diámetro exterior de la rueda delantera	20 cm



dellamed

Versão 01 – Data 26/07/2024



REGISTROS	
NCM	8713.10.00
INMETRO	Possui Certificação
ANVISA	80795950050 - V 80795950061 - CA 80795950063 - I
GTIN	7898952570435

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
11666105000109	DELLAMED S.A.	DELLAMED S.A.	RUA HENRIQUE RECH (LOT SANVITTO LL.), 312 -- CINQUENTENÁRIO - CAXIAS DO SUL, RS - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
DELLAMED	CADEIRA DE RODAS - D100		SIM	MEDIDAS: A890 X L1620 X C1000; PESO LÍQUIDO:13,9KG; PESO MÁXIMO SUPORTÁVEL: 100KG MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO. - CADEIRA DE RODAS	

Certificador: **T&A** N° Certificado: [MED 1820-23-02](#) Tipo: **Produto** Emissão: **05/10/2023** Validade: **05/10/2038** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)